



事前切開したDMEK移植片の明細

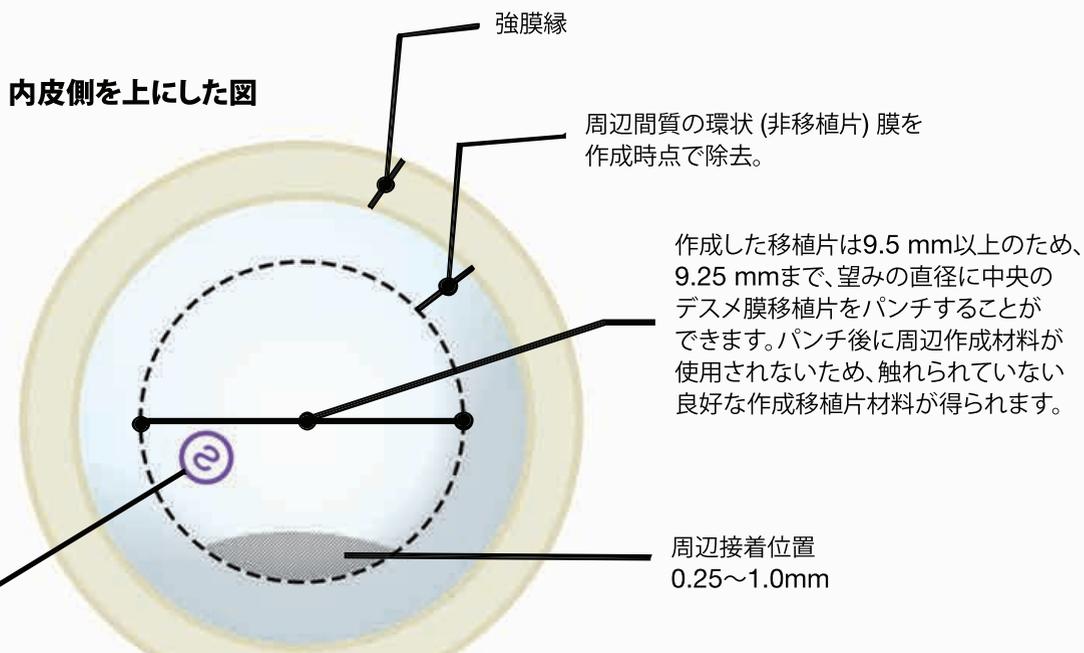


紫色の「S」マークが付いた 膜間質側。術中に患者の眼 で移植片の方向を確認しや すくなります。アイバンクで 「S」マークを付けないよう に、外科医が選択すること もできます。

「V」字型の切り込みは、作成した膜の周辺接着位置を 示します。接着位置は、パンチした作成片の縁から 中心周辺に約0.25~1.0 mmに広がっています。 8.0の移植片では、外科医は膜を分離する必要が ほとんどないか、全くありません。

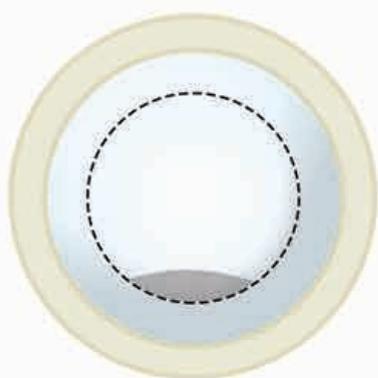

マークなしの直径9.5 mm以上の 作成片 (間質側にマーク、周辺接着 位置の「V」字型の切り込みなし)。

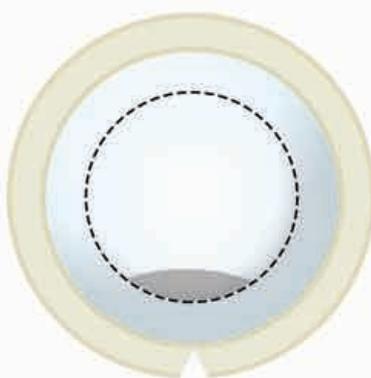

周辺接着位置を示すように 強膜縁に「V」字型の切り込み を入れた直径9.5 mm以上の 作成片。



周辺接着位置を示すように 強膜縁に「V」字型の切り込みを 入れ、膜間質側に「S」マークを 入れた直径9.5 mm以上の作成片。